

ACM

Auto Chip Maker

Butterfly
ODONTOIATRIA & CHIRURGIA



Sistema per la raccolta di osso autologo

efficace


rapido

sicuro



Neo ACM è costituito da una fresa rotante, autoclavabile che permette di prelevare in assoluta sicurezza e facilità una qualità e quantità di osso corticale e spongioso superiore a qualsiasi altro strumento in commercio.

La fresa Neo ACM consente di prelevare fino a 1cc di osso in chips di elevata qualità in circa 10 secondi, nel massimo rispetto dei tessuti nobili grazie allo stopper ammortizzato.

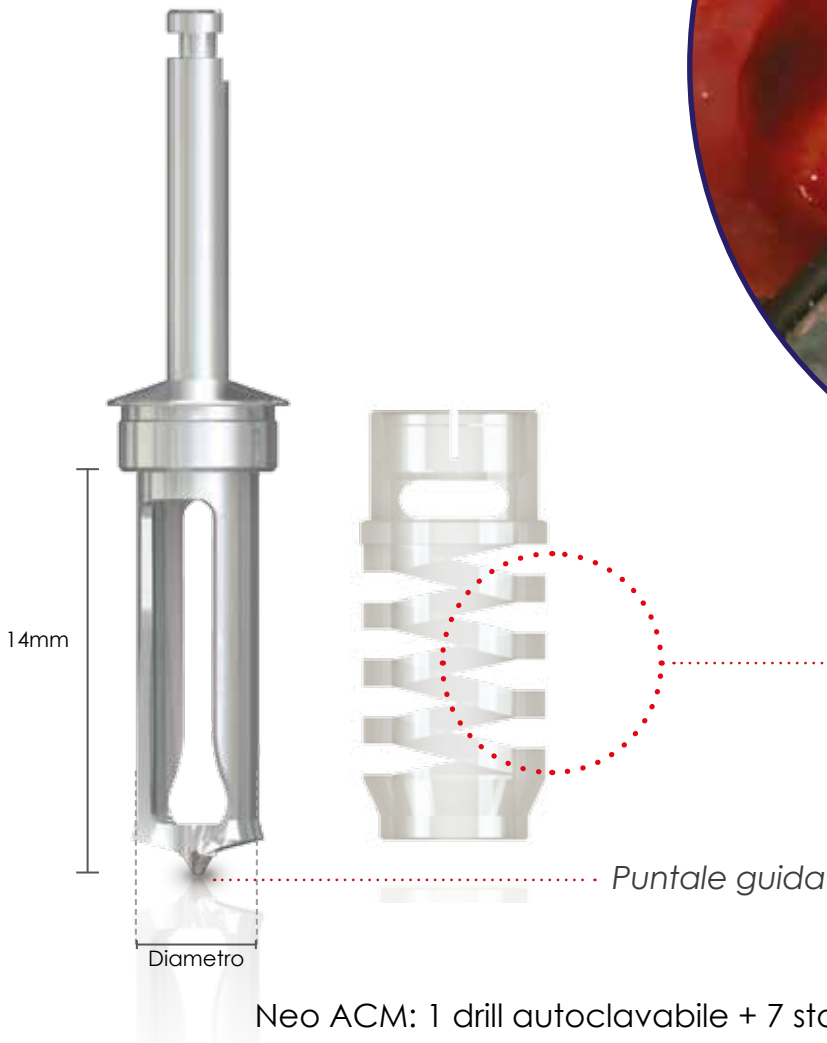


Stopper ammortizzato:
consente di controllare
la profondità di prelievo
(massimo 4mm), garantendo
il rispetto assoluto dei tessuti
nobili.

Neo ACM: 1 drill autoclavabile + 7 stopper sterili, monouso

Diametro	4.0	4.5	5.0
Lungh. 14mm	NACM40ISETS	NACM45ISETS	NACM50ISETS

Velocità di utilizzo: 300 giri/min con irrigazione. Nel caso di utilizzatori del dispositivo ACM già esperti è possibile l'utilizzo senza irrigazione (in modo da non disperdere il sangue del paziente) ad una velocità di 80 giri/min.

Prelievo di osso autologo nel mascellare inferiore

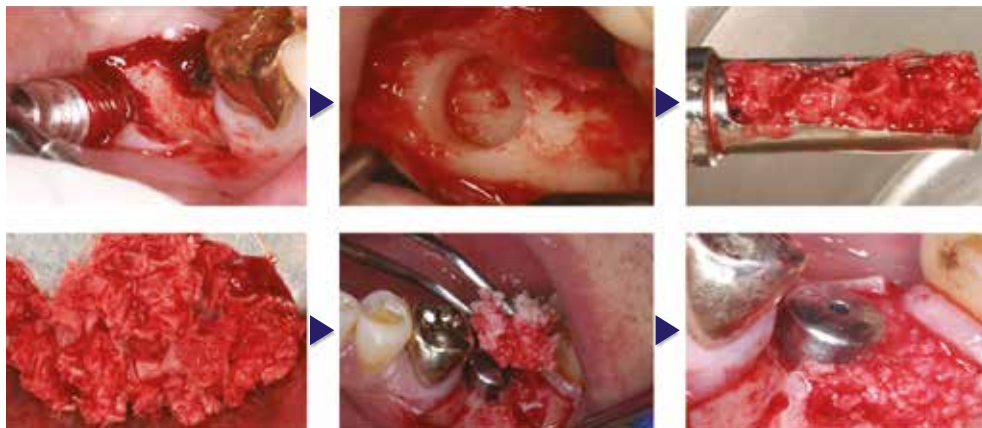

CE0120

Neo_ACM_V01-2025